

令和4年9月

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、測定試薬の変更に伴い内容を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情ご賢察の上、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。 敬白


\*\*\*\*\* 記 \*\*\*\*\*

### ■内容変更項目

#### 項目コード No.22092 B型肝炎ウイルスコア関連抗原

	新	旧
項目コードNo.	22093	22092
基準範囲	2.1未満 LogU/mL	3.0未満 LogU/mL
報告範囲	2.1未満、2.1~7.0、7.1以上	3.0未満、3.0~6.7、6.8以上

### ■新旧の比較

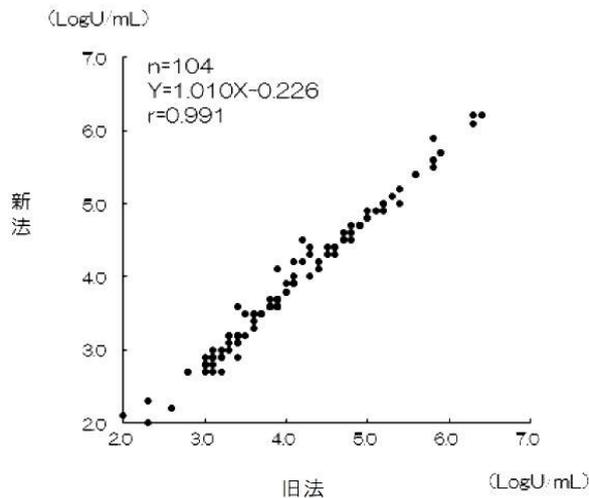

		旧法	
		陰性 <3.0LogU/mL	陽性 ≥3.0LogU/mL
新法	陰性 <2.1LogU/mL	8	0
	陽性 ≥2.1LogU/mL	6	98

一致率：94.6% (n=112)

参考文献 Inoue T, et al : J Hepatol 75(2) : 302~310, 2021. (委託先資料)

### ■変更期日

令和4年10月8日(土)受付分より

以上

22-0928