

令和8年2月

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記検査項目の内容を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。



誠に勝手ではございますが、事情ご賢察の上、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。 敬白

■內容變更項目

項目No.	検査項目名	変更箇所	新	旧
34520	シクロスポリン	検査方法	CLEIA 法	ECLIA 法
		報告上限	4000.0 以上	上限報告無し
		報告桁数	小数第 1 位	整数
34525	タクロリムス	検査方法	CLEIA 法	ECLIA 法
		報告上限	80.00 以上	上限報告無し
		報告桁数	小数第 2 位	小数第 1 位

※基準範囲等に変更はございません。

■新旧の比較

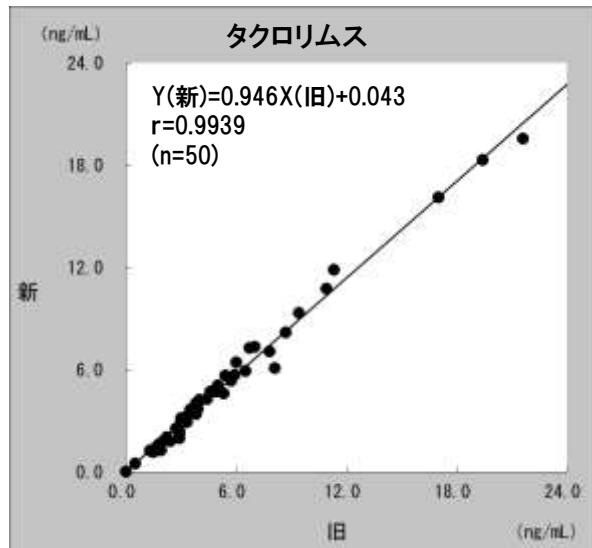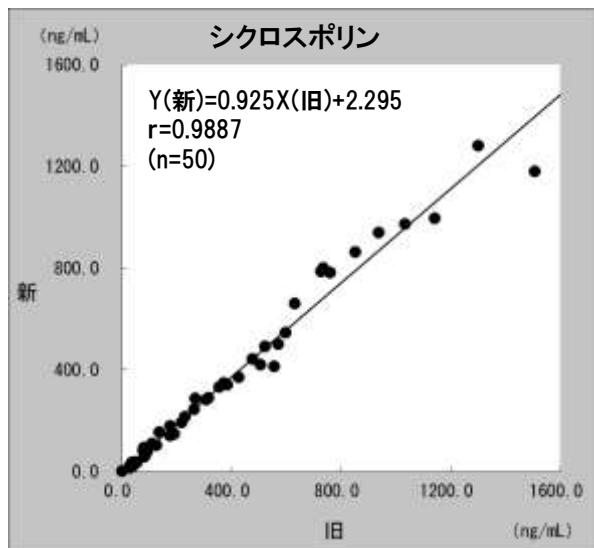

(社内検討資料)

■ 変更期日

令和8年3月2日（月）受付分より

以上

26-0248